




**THUASNE**

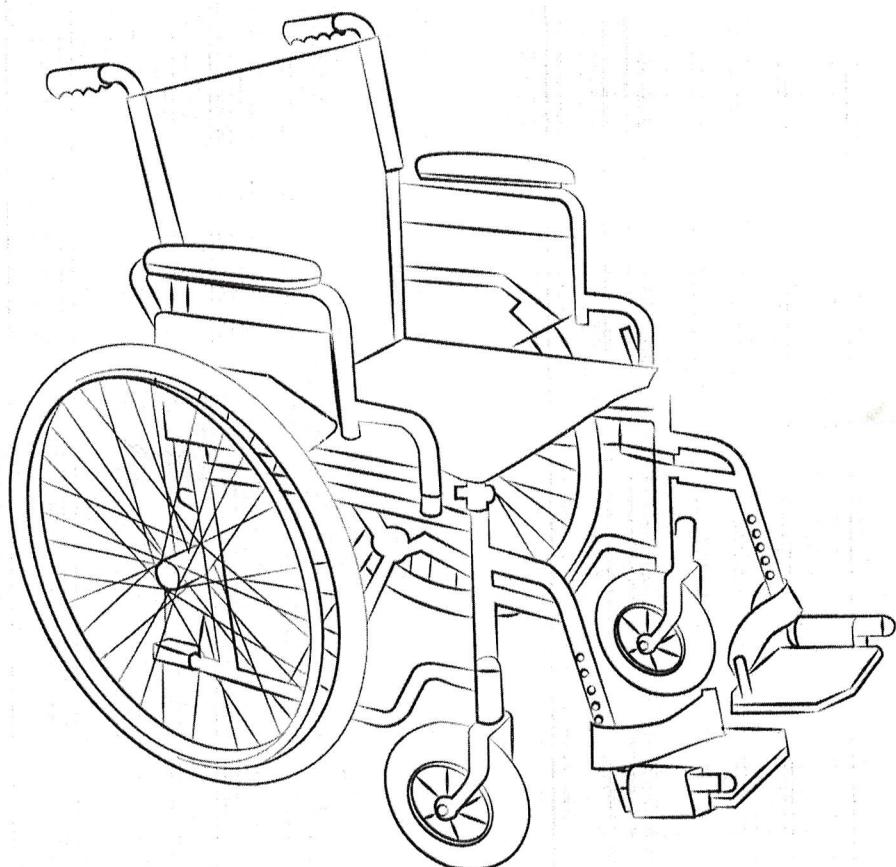

**sk**

## **Invalidný vozík Classic DF 2 - W5310**

### Návod na používanie a údržbu

Tento návod je potrebné odovzdať používateľovi výrobku.

Prečítajte si návod predtým, ako začnete používať **invalidný vozík Classic DF 2**.

Tento návod uchovajte v blízkosti pre prípad potreby použitia v budúcnosti.

Ak chcete získať jeho kópiu, kontaktujte svojho predajcu značky Thuasne (pozrite si adresu na zadnej strane tohto návodu).

<b>1. Oblast použitia</b>	5
1.1. Osoby používající vozík	5
1.1.1. Pacient	5
1.1.2. Asistent	5
1.1.3. Zdravotnícky odborník	5
1.1.4. Technik	5
1.1.5. Predajca	5
1.2. Popis invalidného vozíka	5
1.2.1. Prevádzkové prostredie	5
1.2.2. Obmězenia používania	9
1.2.3. Cieľoví pacienti	9
1.2.4. Obmedzenia používania	9
1.2.5. Psyické schopnosti	9
1.2.6. Fyzické schopnosti	9
1.2.7. Vyber invalidného vozíka	9
1.2.8. Potrebné nastavenia	9
2. Pokyny k použitiu invalidného vozíka	9
2.1. Bezpečnosť	9
2.1.1. Kazdodenná kontrola	6
2.1.2. Stabilita	7
2.1.3. Tren	7
2.1.4. Premiestnenie	7
2.1.5. Dosiahnutie, zvýšenie predmetu zo zeme z invalidného vozíka	8
2.1.6. Pevné/nafukovacie koliesá	8
2.1.7. Demontáž kolies	14
2.1.8. Nastavenie parokovacej brzdy	14
2.1.9. Sklopenie výšky opierok noh	15
2.1.10. Protí prevráteniu (stabiliza dostupné u väčšieho predajcu)	16
2.1.11. Sklopenie / demontáž a montáž opierok lytky (prislúšenstvo dostupné u väčšieho predajcu)	17
2.1.12. Nastavenie skloien opierok lytky	17
2.1.13. Nastavenie opierok lytky	17
2.1.14. Upevnenie pásu	18
3. Použitie invalidného vozíka	7
3.1. Teren	7
3.2. Zataženie a rovnováha	7
3.2.1. Zataženie a rovnováha	7
3.2.2. Pohyb na invalidnom vozíku	7
3.3. Premiestnenie	7
3.3.1. Dosiahnutie, zvýšenie predmetu zo zeme z invalidného vozíka	8
3.3.2. Prekážky	8
3.3.3. Rampy a nájazdy - Bočné nájazdy	8
3.3.4. Obrubníky	8
3.3.5. Schody	11
3.4. Parakovacia brzda	13
3.4.1. Látkové opierky	13
3.4.2. Rozloženie a uskladnenie invalidného vozíka	12
3.4.3. Nastavenie výšky opierok lytky	12
3.4.4. Demontáž a montáž opierok lytky (prislúšenstvo dostupné u väčšieho predajcu)	17
3.4.5. Pevné/nafukovacie koliesá	14
3.4.6. Demontáž kolies	14
3.4.7. Nastavenie parokovacej brzdy	14
3.4.8. Sklopenie výšky opierok noh	15
3.4.9. Nastavenie výšky opierok noh	16
3.4.10. Protí prevráteniu (stabiliza dostupné u väčšieho predajcu)	16
3.4.11. Sklopenie / demontáž a montáž opierok lytky (prislúšenstvo dostupné u väčšieho predajcu)	17
3.4.12. Nastavenie výšky opierok lytky	17
3.4.13. Nastavenie opierok lytky	17
3.4.14. Upvenenie pásu	18
4. Nastavovacie príky invalidného vozíka	4
4.1. Rozloženie a uskladnenie invalidného vozíka	12
4.1.1. Rozloženie a uskladnenie invalidného vozíka	12
4.1.2. Nastavenie výšky opierok lytky	13
4.1.3. Nastavenie opierok lytky	13
4.1.4. Demontáž a montáž opierok lytky	17
4.1.5. Nastavenie skloien opierok lytky	17
4.1.6. Nastavenie opierok lytky	17
4.1.7. Nastavenie výšky opierok lytky	17
4.1.8. Sklopenie / demontáž a montáž opierok lytky (prislúšenstvo dostupné u väčšieho predajcu)	17
4.1.9. Nastavenie výšky opierok lytky	16
4.1.10. Protí prevráteniu (stabiliza dostupné u väčšieho predajcu)	16
4.1.11. Sklopenie / demontáž a montáž opierok lytky (prislúšenstvo dostupné u väčšieho predajcu)	17
4.1.12. Nastavenie výšky opierok lytky	17
4.1.13. Podmenky používania	18
4.1.14. Bezpečnosť panovový pás (prislúšenstvo dostupné u väčšieho predajcu)	18
4.1.15. Nastavenie výšky opierok lytky	17
4.1.16. Nastavenie výšky opierok lytky	17

<b>5.</b>	<b>Rýchle odstránenie poruchy .....</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>Technická špecifikácia.....</b>	<b>20</b>
6.1.	Normy a nariadenia .....	20
<b>7.</b>	<b>Označenia.....</b>	<b>21</b>
7.1.	Výrobný štítok.....	21
7.2.	Iné označenia.....	21
<b>8.</b>	<b>Návod na údržbu .....</b>	<b>22</b>
8.1.	Potrebné náradie .....	22
8.2.	Pravidlá pre manipuláciu .....	22
8.3.	Čistenie .....	22
8.4.	Dezinfekcia.....	23
8.5.	Kontrola celkového stavu invalidného vozíka.....	23
8.6.	Frekvencia kontrol.....	25
8.7.	Dlhodobé skladovanie invalidného vozíka.....	26
8.8.	Opäťovné použitie invalidného vozíka.....	26
8.9.	Predpokladaná životnosť invalidného vozíka .....	26
8.10.	Likvidácia .....	26
8.11.	Záruka.....	26
8.12.	Náhradné diely .....	26
8.13.	Príslušenstvo .....	26
<b>9.</b>	<b>Záručný list .....</b>	<b>27</b>

## Pre zrakové posťihnutých ľudí je možné si vyziaľať návod so záväzneným textom:

Pri preberaní vozílka skontrolujte, či je dodávka uplná a či obal nie je poškodený. Aklikoľvek reklamáciu týkajúcu sa vidiťelných či skôd je potrebné okamžite nahlásiť.

Na Vás invalidný vozík sa vzťahuje záruka dva roky od dňa zakúpenia zdravotníckej pomôcky. Pozrite si odsiek 8.11 v tomto návode.

**V tomto návode plikogram „Upozornenie“ označuje potenciálne nebezpečenstvo súčasťou alebo sa s vásom lekármi alebo predajcom Thusaene.**



Spoločnosť Thusaene si využaduje právo vykonať úpravy bez predchádzajúceho upozornenia. V dosledku toho je možné, že niektoré časti textu budú bezpredmetne alebo že obrazky budú miestne upravené.

Udržbu vozílka musí vykonávať špeciálne vyskolený personál.

Pokyny týkajúce sa používania uvedené v tomto návode predstavujú všeobecné upozornenia. V prípade potreby bezpečnostné prejazdu spoločnosti Thusaene alebo svojho lekára a dorzávajte ich rady týkajúce sa používania kontaktného pracovníka spoločnosti Thusaene sú uvedené na konci tohto návodu.

Tento vozík môžu bez pomocí asištenia používať len osoby fyzicky a duševne spôsobilé na jeho používanie.

Väsetky doplnujúce informácie ziskate u svojho lekára alebo predajcu, dorzájte ich odporúčania.

Dôležité si prostim prečítajte celý návod skôr, ako použíte svoj nový vozík.  
Na správne používanie tohto vozíka je potrebné záskolenie, aleko aj správne pochopenie tohto návodu.

Tento návod poskytuje informácie o používaní invalidného vozíka o jeho údržbe, o potrebnom nastavení a s tým súvisiacimi obmedzeniami a nebezpečenstvom. Pred použitím väšho nového invalidného vozíka si prostim pozorne prečítajte celý návod. Nachádzaťe doň tak často, ako budete potrebovať.

Invalidný vozík bude nastavený podľa Vásich potrieb. Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnej funkčnosti invalidného vozíka využívať neponúkajte a konzultujte väčšie dotazy so zdravotníckymi odborníkmi a dorzájte ich odporúčania týkajúce sa efektívneho používania bezpečnostných pravidiel.

Vás predajca a Vás osetrojučí lekar vám pomohli pri výbere alebo predplisaní tohto invalidného vozíka s ohľadom na väčšie potreby. Pomôžu Vám s jeho manipuláciou a záistia, že Vás invalidný vozík je správne nastavený a pripravený pre väčšie potreby a používanie.

Práve ste získali invalidný vozík Classic DF 2 Thusaene. Dakujeme Vám za dôveru.

**Invalidný vozík Classic DF 2 - W5310**  
**Návod na používanie a údržbu -**

## **1. Oblast použitia**

### **1.1. Osoby používajúce vozík**

Iba kvalifikovaný personál je schopný odhadnúť riziká, ktoré by mohli spôsobiť zranenia alebo materiálne škody, a teda bezpečné používanie funkcií tohto vozíka. Rôzne úkony opísané v tomto návode si vyžadujú rôzne kompetencie.

#### **1.1.1. Pacient**

Pacientom sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá potrebuje starostlivosť, alebo akákoľvek staršia alebo postihnutá osoba, ktorá sedí vo vozíku.

#### **1.1.2. Asistent**

Používateľ využívajúci funkcie tohto vozíka musí dokonale poznáť návod na používanie a bezpečnostné upozornenia opísané v tomto návode, ako aj možné nebezpečenstvá spojené s ovládaním týchto funkcií.

V tejto súvislosti si treba pozorne prečítať a správne pochopiť tento návod. Je dobré využiť aj pokyny a zaškolenie kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom.

Najčastejšími používateľmi sú asistenti, ošetrovatelia a pacienti (podľa odporúčaní kvalifikovaného zdravotníckeho personálu).

#### **1.1.3. Zdravotnícky odborník**

Kvalifikovaný zdravotnícky odborník, ktorý je vyškolený v oblasti, kde sa výrobok používa, a pozná legislatívu, pravidlá a dôležité pokyny týkajúce sa invalidných vozíkov.

Po analýze potrieb pacienta a jeho prostredia zdravotnícky pracovník odporučí tento vozík, nastavenia a zariadenie vhodné pre potreby pacient/a a/alebo používateľov.

Odporučajúci lekár je zdravotnícky odborník.

#### **1.1.4. Technik**

Osoba alebo subjekt vyškolený a skúsený v oblasti mechaniky, ktorý pozná pravidlá a predpisy týkajúce sa montáže, údržby a opravy invalidného vozíka. Váš predajca je technik.

#### **1.1.5. Predajca**

Pred odovzdaním tohto invalidného vozíka ho bude Váš predajca nastavovať v súlade s predpismi, overí jeho mechanické funkcie, informuje vás (ako aj vášho asistenta alebo asistentov) o jeho funkčnosti a o bezpečnostných postupoch a overí prípadné kontraindikácie.

## **1.2. Popis invalidného vozíka**

Invalidný vozík je skladací manuálny vozík.

Je zhotovený tak, aby pacientovi v sediacej polohe poskytol maximálny komfort a samostatnosť, pričom je zaručená jednoduchá ovládateľnosť a ergonómia pre asistenta.

**Pozrite si schému v kapitole 4 tohto návodu s označením „Nastavovacie prvky invalidného vozíka“.**

Invalidný vozík je zhotovený z nehorľavých materiálov a látok.

## **1.3. Prevádzkové prostredie**

Invalidný vozík je určený na vnútorné aj vonkajšie použitie a môže byť obsluhovaný samostatne alebo asistentom sprevádzajúcim osobu na vozíku.

Tento vozík nie je prispôsobený na používanie v motorovom vozidle.

Tento vozík nie je zhotovený na používanie s infúzny stojanom, vreckom na moč, kyslíkovou fľašou alebo držiakom na palicu.

	Nevystavujte vozík teplote vyšej ako 39 °C.
	Nevystavujte invalidný vozík priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla. Prudký nárast teploty povrchu invalidného vozíka môže používateľovi spôsobiť popáleniny.
	Buďte opatrní pri používaní sedačky do vozíka, deky alebo iných ochranných pomôcok, ktoré by mohli byť horľavé.
	V prípade, že invalidný vozík bol používaný vonku v horších poveternostných podmienkach, je potrebné dôkladne ho poutierať do sucha suchou handrou.
	Dodržujte platné pravidlá cestnej premávky a dopravné predpisy.
	Neprekračujte maximálne zaťaženie invalidného vozíka 120 kg vrátane batožiny.

 Opiery růlk, pneumaticky a brzdy je potrebovat káždy deň.

aj tento vozík sa musí pravidelne kontrolovať. Pozrite si odsek 8.6. „Frekvenčia kontroly“ v tomto návode.

Vás invalidný vozík je zhotovený tak, aby fungoval spoločivo s bezpečné. Avšak tak ako kážde mechanické zariadenie,

## 2.2. Káždodenná kontrola

 Aby nedoslo ku zraneniu, nevkľadajte prsty alebo iné časti tela do pohybujúcich sa častí.

Osoba, ktorá vám asistuje, musí takisto presť vodiacym školiením a musí byť v dobrej fyzickej kondícii.

Poradte sa so svojim lekárom, aby stanovil najvhodnejšie bezpečnostné opatrenia podľa vašich individuálnych schopností.

Je veľmi dôležité naučiť sa bezpečnostné pravidlá a neuštále ich dodržiavať pri využívaní káždodennej činnosti.

Bezpečnosť si vyžaduje neustálu pozornosť osobám, ktorá sedí na vozíku alebo jej asistentka.

## 2.1. Bezpečnosť

### 2. Pokyny k použitiu invalidného vozíka

Používať a že rozumiete pokynom z návodu.

Vás predajca skontroluje nastavenie vozíka, aby sa uistil, že vám vozík a zvolené nastavenia umozňujú bezpečné ho

Techník výkonať tieto nastavenia podľa predpisania lekárom.

Pred používaním sa musí invalidný vozík dôkladne nastaviť v závislosti od vašich potrieb.

#### 1.4.2.4. Potrebné nastavenia

Zohľadniť fyzickú kondiciu záskolenie vašho potenciálneho ošetrovateľa alebo asistenta.

Po preskúmaní vašich potrieb a vašich okolia vám zdravotnícky odborník predpísie invalidný vozík, poradiť Vám ohľadom nastavenia, prislúšensťa a vašich skôolení.

#### 1.4.2.3. Vyber invalidného vozíka

Pred predplisaním používania invalidného vozíka je potrebné zohľadniť nasledky niektorých fyzických porúch:

#### 1.4.2.2. Fyzické schopnosti

Tento vozík nesmú používať pacienti, ktorí majú psychické poruchy, amputácia spôsobená vreckom končatiny vysoko až do kolene, rozehodovaním, okrem prípadov, ak zdravotnícky pracovník schválí jeho používanie po zhodnotení s poruchami.

Tento vozík nesmú používať pacienti s psychiatrickými poruchami.

#### 1.4.2.1. Psychické schopnosti

#### 1.4.2. Obmedzenia používania

Tento invalidný vozík je špeciálne zhotovený pre pacientov starších ako 12 rokov s maximálnou hmotnosťou 120 kg.

#### 1.4.1. Cieľoví pacienti

#### 1.4. Popsi cieľové skupiny pacientov

### 3. Použitie invalidného vozíka

#### 3.1. Terén

Nepoužívajte invalidný vozík na nerovnom teréne alebo na mäkkom povrchu (piesok, bahno...).

Nepoužívajte vozík na klzky alebo zládovatených povrchoch.

Uistite sa, že je cesta bez prekážok.

Ak je váš vozík vybavený zariadením proti prevráteniu, uistite sa, že je tento systém aktívny a zablokovaný v spodnej polohe.

#### 3.2. Stabilita

Pri navrhovaní vozíka bola zvláštna pozornosť venovaná jeho stabilité. Napriek tomu je možné, aby sa prevrátil, ak sa nepoužíva správne.

##### 3.2.1 Zaťaženie a rovnováha



Nepripevňujte ani nepripájajte čokoľvek k invalidnému vozíku. Mohlo by tak dôjsť k prevráteniu, prípadne k poškodeniu vozíka alebo vám spôsobiť zranenie.



Nepoužívajte invalidný vozík ako oporu pri chôdzi – riskujete stratu rovnováhy a zranenie.

##### 3.2.2 Pohyb na invalidnom vozíku

Nenakláňajte sa dozadu s cieľom dosiahnuť predmety za vozíkom. Nenakláňajte sa nabok.



Nikdy nenahýbajte invalidný vozík zdvihnutím predných kolies do rovnovážnej polohy **bez asistencia inej osoby**, tento úkon je nebezpečný a môže spôsobiť zranenie.



Nekladte na podnos alebo príručný stolík žiadne predmety alebo nádoby, ktoré by v prípade pádu alebo prevrátenia mohli zraniť používateľa (napr. horúce kvapaliny).

#### 3.3. Premiestnenie

Premiestnenie sa na vozík alebo z vozíka je veľmi náročná operácia. Príjmite preto mimoriadne bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k prevráteniu. Kedykoľvek je to možné, požiadajte pri premiestnení o pomoc.

Buďte veľmi opatrní pri premiestňovaní bez pomoci asistenta alebo s pomocou zdviháka.

##### Bočný presun




##### Pred presunom

- Priblížte vozík čo najbližšie k sedadlu, kde chcete sedieť.
- Umiestnite predné kolieska rovno dopredu kvôli zvýšeniu stability.
- Uistite sa, že vozík je na rovnom, stabilnom povrchu a zaistite kolesá.
- Presvedčte sa, že je vozík stabilizovaný a nebude sa počas premiestnenia pohybovať.
- Sklopte opierky nôh. Buď ich odstráňte, alebo ich pootočte nabok.

##### Počas presunu

Nestúpajte ani nechodať po opierkach pri premiestnení sa do alebo z vozíka. Mohlo by to spôsobiť prevrátenie vozíka alebo samovoľný pohyb vozíka.

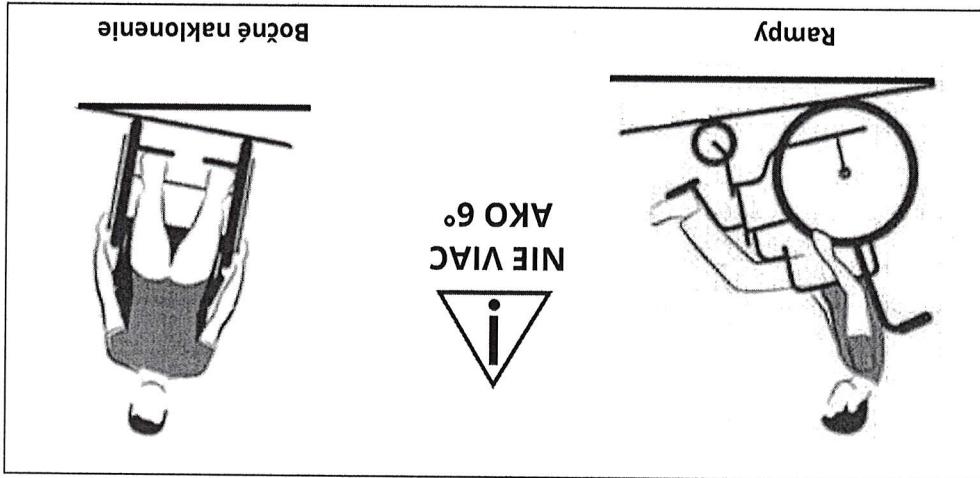

Neriskujte na rampách, najazdoch a bocných nákladoch so sklonom vyšším ako šesť stupňov (6°).



Neotáčajte sa na vozíku, keď idete hore kopcom alebo dolu kopcom. Mohol by sa preverať.



že je tento systém západný a záblokovany v spodnej polohе.  
Súčasťou proti preveraťu Vám poskytne predajca. Ak je Vás vozík vybavený týmto zariadením, uistite sa,



skor než využete na rampu, zhadnite možné nebezpečenstvá: kľuky alebo nerovny povrch, diera. Ak nevidite na celu rampu, pozriajte niekoho, aby ju preveril.

### 3.5.1 Rampa a nájazdy - Bocné nákladky

Obrubníky, schody a eskalátory sú bezpečnej prekážkami. Vždy sa im snážte vyhnúť použitím rampy alebo vytáhu. Zhadnite svoje vlastné schopnosti a limity, čo sa tyka sily a výtrvalosti. Ich bez pomoci. Nátrahuje si prekonávanie prekážok násikor s asistenčnou alebo zdravotníckym pracovníkom, než sa pokúsite zdolať

### 3.5. Prekážky

Nepokúsajte sa dosiahnuť na predmet, ak by ste sa museli zo sedadla náklonit dopredu. Nepokúsajte sa zvlniť predmety položené na zemi, ak by ste sa museli nahýbať cez kolena.



Pozor na stratu rovnováhy, ktorú môže vyuvať hmotnosť zadržaneho predmetu. V prípade pochybností pozriajte níekoho o pomoc.

Ak na predmet nedosiahnete, zmŕtvejte polohu vozíka alebo pozriajte níekoho o pomoc.

Zatiaľnute parkovaci brzdu, trup držte vo vzpriamenej polohе na sedadle a rukou zatiaľnute smerom k predmetu.

Otočte obidve prsné smerové kolieska rovno dopredu.

Približte vozík do najblízszej k predmetu, ktorý chceťe dosiahnuť.


### 3.4. Dosiahnutie, zvlniť predmet zo zeme z invalidného vozíka

## Výstup na rampu



Pri stúpaní do svahu sa mierne nakloňte hornou časťou svojho tela dopredu. Ak bude nutné sa zastaviť na svahu a potom sa znova rozbehnúť, vyhnite sa prudkému alebo náhlemu tlaku na obruč, čo by mohlo spôsobiť prevrátenie.

## Zostup z rampy

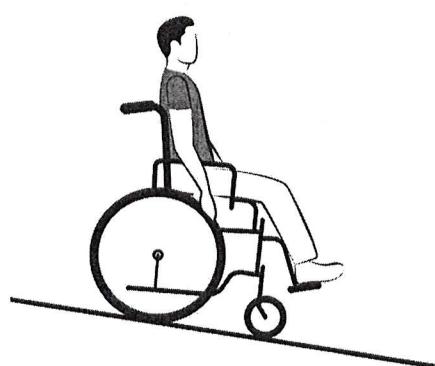


Pri zostupe si dávajte pozor na vzdialenosť opierok nôh od zeme. Na zvýšenie stability sa mierne nakloňte dozadu. Zostup by mal byť vykonávaný pomaly a veľmi opatrne s pridržiavaním obruče. Dávajte si pozor na teplo, ktoré vzniká trením pri držaní obruče. Je potrebné schádzať pomaly.




Počas zostupu buďte vždy obrátený čelom dopredu.



Nikdy nepoužívajte parkovaciu brzdu na spomalenie zostupu. Môže to spôsobiť nebezpečné zablokovanie jedného alebo aj oboch kolies a prevrátiť tak vozík nabok alebo dopredu.
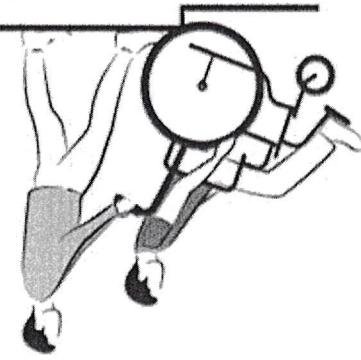
<p>Asistent: - otočí invalidiný vozík zádymi kolесami k obrubníku.</p> <p>- nákolon vozík dozadu do rovnovážné polohy, taha ho obrubníku.</p> <p>- otočí invalidiný vozík zádymi kolесami k obrubníku.</p> <p>- nákolon vozík dozadu do rovnovážné polohy, taha ho obrubníku.</p> <p>- na hornu hranu obrubníka při záchování rovnovážné polohy, potom číva spáť, pokým predeň kolesa pěvne na zemi.</p> <p>- opět o patrné položi vozík a skontroluje, či sú predeň na horni hranie obrubníka,</p>	
<b>Obrubníky: Vystup zelenom vzd</b>	
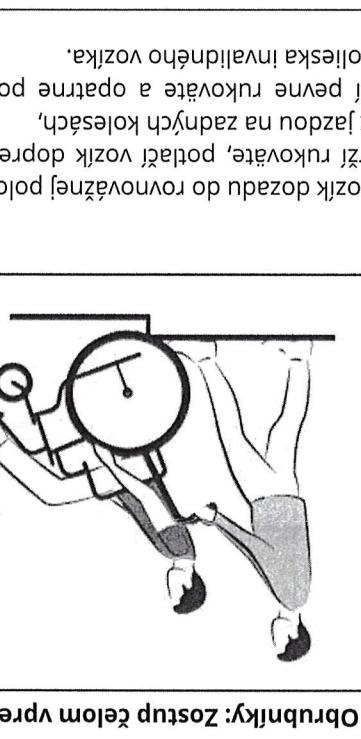
<p>Asistent: - dáváste pozor, aby ste nenarazili opierkami noh na obrubník.</p> <p>- nákolon vozík dozadu do rovnovážné polohy,</p> <p>- posuníte invalidiný vozík dopředu tak, aby sa predeň kolieska dostali na chodník,</p> <p>- zatáčí, aby sa vozík dostal na obrubník zádymi koliesami vozíka.</p>	
<b>Obrubníky: Zosten zelenom vpred</b>	

<p>Asistent drží obe držadla a nákolon vozík směrem dozadu, kým sa nedostane do rovnovážné polohy:</p> <p>- asistent môže nahoru stlačit pedál výváženia,</p> <p>- osoba sediacá na sedadle invalidiného vozíka môže zjednodušiť pochybnej mieronym odskutum trupu, pričom zatáčí obrúče kolies dopředu.</p>	
<b>"Nákláňanie"</b>	

V prípade, že nie je k dispozícii rampa alebo výtah, posíládaťe inú osobu, aby vám pomohla. Osoba, ktorá vám asistuje, musí mať zodpovedajúce záskolenie. Vedenie invalidného vozíka v rovnovážné polohé vyžaduje dobrú koordináciu medzi asistentom a používateľom a určitu fyzickú silu.



### 3.5.2 Obrubníky


### 3.5.3 Schody



Nikdy nepoužívajte eskalátor na presun invalidného vozíka medi jednotlivými podlažiami. Mohlo by to mať za následok závažné poranenia.

Pri výstupe alebo zostupe zo schodov sú potrebné dve skúsené osoby.

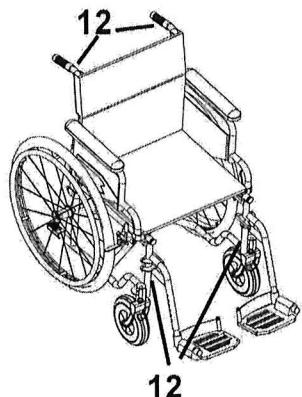Úchopové body	
 	 <p>Ak chcete niestť alebo uchopiť invalidný vozík, držte ho za úchopové body označené na obrázku číslom 12. Nikdy nedržte invalidný vozík za opierky rúk alebo nôh.</p>

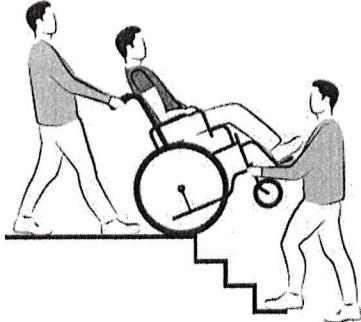	<p>Chodťte po jednom schode. Vozík sa nesmie inak nakloniť skôr, ako budete mimo schodiska.</p>
---	---



Skontrolujte správnou polohu sedadla na podperách.

Zapojte rámu a pravu brzdu a zem. Uchopte laktovu opierku a miernu nakloňte vozík kolieskami na zem. Postavte sa vedľa vozíka. Pokym tkanina sedadla nie je napnutá, rozložte opierky noh. Zatiaľ tak, aby ste nadvhili kolieska na opäčnej strane.	- Postavte vozík kolieskami na zem. - Zatiaľ tak, aby ste nadvhili kolieska na opäčnej strane. - Pokym tkanina sedadla nie je napnutá, rozložte opierky noh.	
<b>Rozloženie vozíka</b>		




Nikdy nedávajte prsty medzi sedadlo a rámu! Na tlačenie použite dlanie.

Nikdy nezdvihajte invalidný vozík za jeho pochyblivé časti: opierka na nohy, laktové opierky, koliesá, atď. Invalidný vozík sa môže zliztiť, aby sa zjednodušilo jeho uskladnenie a preprava.

#### 4.1. Rozloženie a zloženie invalidného vozíka

1	Skladací rám
2	Tkanina opieradla
3	Tkanina sedadla
4	Laktová opierka
5	Opliarka ruky
6	Predné smerové koliesko
7	Zadné kolieso
8	Svoraka na rýchlu demontáž zadných kolies
9	Parkovacia brzda
10	Bezpečnosťny panovový pas (v závislosti od modelu)
11	Opliarka noh

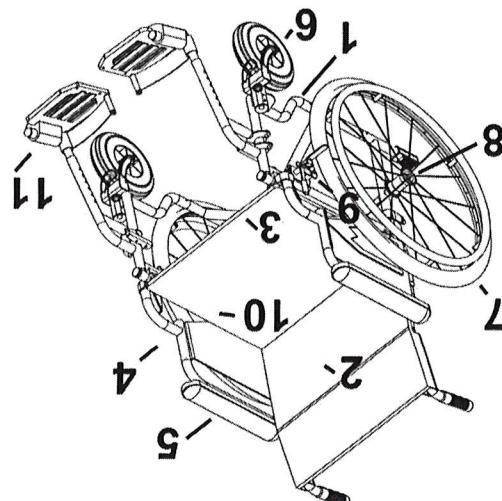

#### 4. Nastavovacie prvky invalidného vozíka

Zloženie vozíka		
<p>Nezabudnite vyprázdiť zadné vrecko.          Vyberte sedačku do vozíka, v prípade, že ju používate.          Sklopte opierky nôh alebo opierky lýtok pozdĺž ich držiakov.</p>	<p>Uchopte obidva okraje tkaniny sedadla v strede a zdvihnite.</p>	

#### 4.2. Preprava a uskladnenie

Po zložení môžete invalidný vozík uložiť do malého priestoru alebo ho môžete prepravovať vzadu v aute alebo v batožinovom priestore.

Ak chcete manipulovať so zloženým vozíkom, uchopte ho za dva popruhy nachádzajúce sa na vrchnej časti sedadla.

Pre jednoduchšiu prepravu môže byť praktické odstrániť zadné kolesá, keď je vozík vybavený kolesami s rýchlosťou demontážou, ako aj opierky nôh a/alebo opierky lýtok.

#### 4.3. Laktové opierky

Obidve laktové opierky sú demontovateľné.

Odklopenie laktovej opierky	Umiestnenie laktovej opierky do správnej polohy
Blokovaciu páčku zatlačte dopredu.	Potom nadvihnite laktovú opierku.
	Sklopte laktovú opierku, kým nezapadne do svojho miesta.
	Overte, či je laktová opierka zablokovaná tak, že ju potiahnete nahor.

<p>Parkovacia brzda musí být v uvolneném polohu.</p> <p>Stiskněte středové tlačidlo na osi kolesa, nastavte ho oproti náboji kolesa a pevně ho zatlačte.</p>	
<b>Spatná montáž koles</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadřízte vozík rovno a zopakujte tuto operaci až při druhém kolesu.</li> <li>- Polozte koleso na zem alespoň ho opřete o stenu.</li> <li>- Vytištěníte von.</li> <li>- Tlačidlo držte stiskněte a ostatními prsty si chopte náboj kolesa a koleso zaráďte na rychnu demontaž (1).</li> <li>- Jedenou rukou držte vozík rovno a palcem druhé ruky stiskněte středové tlačidlo na zaráďenou ruku opětou opírekou v spodní polohu.</li> <li>- Zablokujte lehkou opětkou brzdu.</li> <li>- Od blokujte parkovací brzdu.</li> <li>- Dajte vozík do sklopné polohy.</li> </ul>	
<b>Demontaž koles</b>	

Využijte jednoduchy sposob demontaže zadních koles.

V závislosti od vzdalenosti a kompetence osob, která tuto činnost vykonává, je možné použít různé metody. Tu je tato operačka sa môže vykonáť rukou, keď sú zadné kolesá vybavené systémom ryčieľ demontaže.

#### 4.6. Demontaž koles

Predne a zadne kolesá zabezpečí dlehozde bezproblémové používanie vozítka.

#### 4.5. Pevné/nafukovacie kolesa

	Brzdy siľuia na zastavenie vozítka a prípadne dlišieho statia. V záidanom prípade sa nesmú použiť na spomalenie vozítka.
--	--


	Počas brzdenia nechajte ruky a prsty na rukoväti brzdy, aby sa Vám ruky a prsty nezachytia do pochybných dielov brzdeného zaráďenia.
--	--

	<p>Zatlačte rukoväť smerom dopredu Potiahnite rukoväť smerom dozadu</p>
	<p>Zablokovanie zadných koles Od blokovať zadných koles</p>

#### 4.4. Parkovacia brzda



Overte, či sú osi kolies celkom zasunuté: blokovacie guličky musia presahovať ložisko a bočná vôľa nesmie presahovať 2 mm.

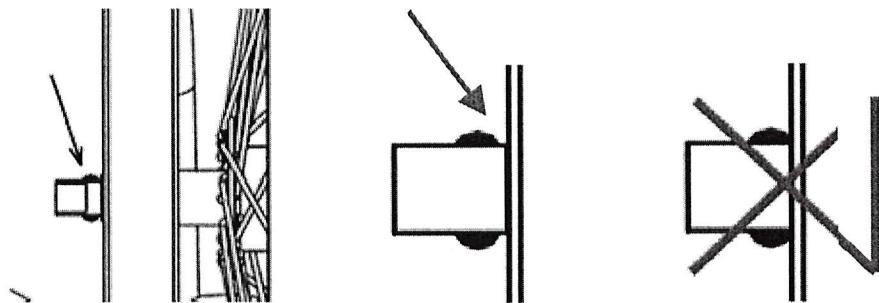

#### 4.7. Nastavenie parkovacej brzdy




Toto nastavenie by malo byť zverené odborníkovi.

Nastavenie sa musí vykonať na oboch brzdách, s namontovanými zadnými kolesami. (V prípade nafukovacích kolies musia byť obe nafúknuté rovnako na predpísaný tlak.)

Uvoľnite blokovacie matice mechanizmu brzdy, aby sa mohol posúvať na bočnej strane. Mechanizmus brzdy nastavte do požadovanej polohy. Dotiahnite matice.

Skontrolujte funkčnosť bŕzd. V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky, pokým nie sú brzdy správne nastavené.

#### 4.8. Sklopenie / demontáž a montáž opierok nôh

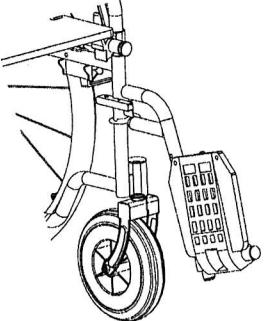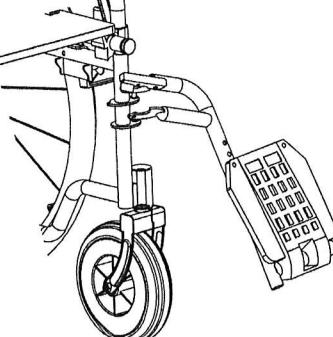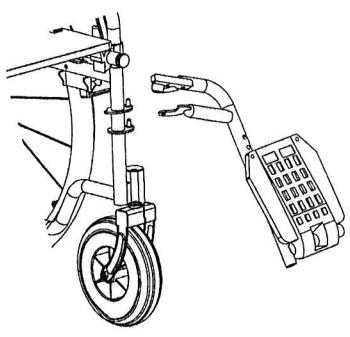Sklopenie	Demontáž	
		
Pomocou integrovanej páky odblokujte mechanizmus a otočte opierku na nohy smerom von od vozíka.	Vytiahnite opierku na nohy z 2 osí alebo fixačných čapov.	

##### Spätná montáž:


Každá z opierok je zvlášť na pravú alebo ľavú stranu. Nezamieňajte ich. Vyrovnajte otvory držiakov s osami a upevnite opierky na držiaky rámu.

Otočte držiak do prednej polohy vozíka, pokým nezapadne západka. Dobre skontrolujte, či západka správne zapadla.



Existuje riziko preverátenia, ak používatel nie je informovaný o deaktivácií zariadenia proti preveráteniu.

#### Deaktivácia zariadenia proti preveráteniu



- Skontrolujte, či je zariadenie správne zalistené.
- Uistite sa, že poslka uplnie vyčadza z otvoru rámu.
- Stlačte poslku a otocťe zariadenie s kolieskami otocenými smermom hore.
- Nastavte zariadenie s malými kolieskami v blízkosti zeme, kým poslka nezapadne na miesto.
- Stlačte poslku a vložte zariadenie proti preveráteniu.
- Vytiahnite gumený kryt z rámu vozalka.

#### Nastavenie zariadenia proti preveráteniu v aktívnej polohe



Vlhkej zemi, vytločch, atd.

Existuje riziko preverátenia vozalka, ak sa bude zariadenie proti preveráteniu používať na nerovinej zemi,

Funkcia proti preveráteniu nebude funkčná, ak bude zariadenie nesprávne nastavené alebo chybne.  
Zariadenie proti preveráteniu sa musí použiť na pevnom povrchu, jeho činnosť sa obmedzi alebo zruší, ak male kolieska nebudú prilehať k zemi.  
Su môže dve polohy: aktívna poloha a neaktívna poloha.  
Tieto súčiastky je vložená do zadnej časti konštrukcie rámu a je zabezpečená pomocou posliek.  
Stúpiatka proti preveráteniu obmedzuje naklonenie dozadu, čím sa zníži riziko preverátenia invalidného vozalka.  
Táto inštalácia a nastavanie by mali byť zvereňe odボռнлкovi.

#### 4.10. Proti preveráteniu (súčiastka dosťupna u vás ho predajcu)



Dodržiť vzdialenosť od zeme približne 7 cm, aby sa zabezpečilo kolíziam s prekážkami na zemi.

Odblokujte poslne zariadenie nastaveneim páky do otvorennej polohe.	Pomocou dvoch prstov stlačte 2 bezpečnosťní poslku a páku bez do uzavretej polohe.	Dodržiť vzdialenosť od zeme približne 7 cm, aby sa zabezpečilo kolíziam s prekážkami na zemi.
--	---	---

Táto nastavanie by malo byť zvereňe odボռнлкovi.

#### 4.9. Nastavenie výsky opierok noh




## **4.11. Sklopenie / demontáž a montáž opierok lýtka (príslušenstvo dostupné u vášho predajcu)**

### **4.11.1. Demontáž a spätná montáž**

Pretože tieto opierky sú rovnako upevnené ako opierky nôh, pozrite si bod 4.8. a 4.9. o opierkach nôh.  
Pozn.: Každá z opierok je zvlášť na pravú alebo ľavú stranu. Nezamieňajte ich pozície pri montáži.


### **4.11.2. Nastavenie sklonu opierok lýtka**

Pomocou úchytovej páky umiestnite opierku do požadovaného uhlu. Uvoľnite páku.

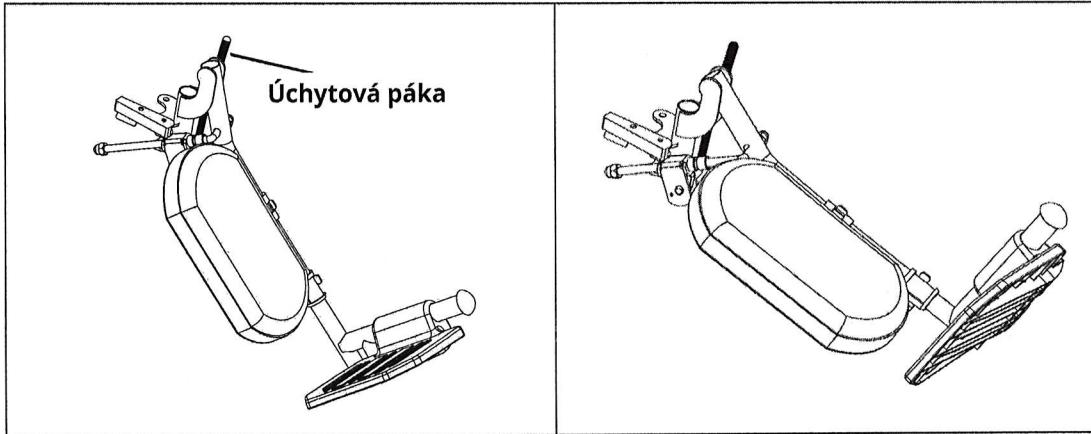

### **4.11.3. Nastavenie opierok lýtka**

Nasmerujte opierku k prednej časti vozíka.

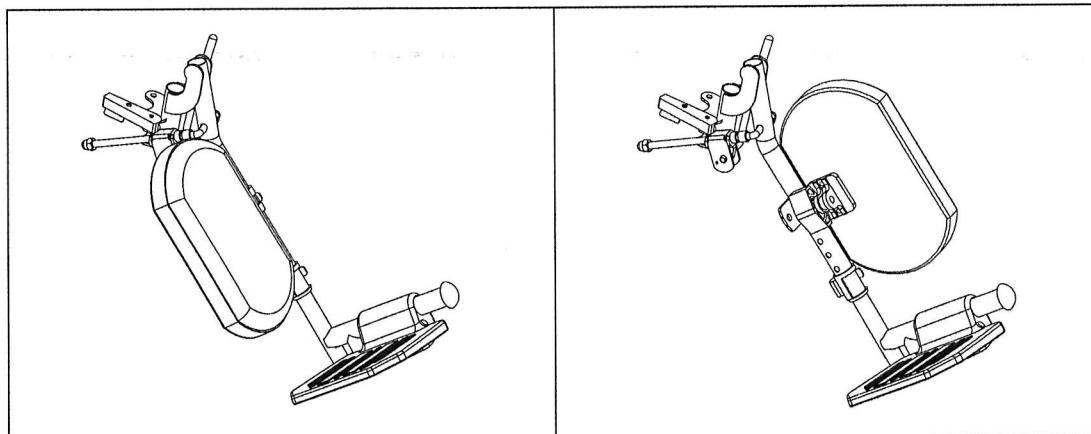


### **4.11.4. Nastavenie výšky opierok lýtka**

Toto nastavenie by malo byť zverené odborníkovi.

Postupujte rovnako ako pri držiakoch opierok nôh.



Dodržujte vzdialenosť od zeme približne 7 cm, aby sa zabránilo kolíziám s prekážkami na zemi.

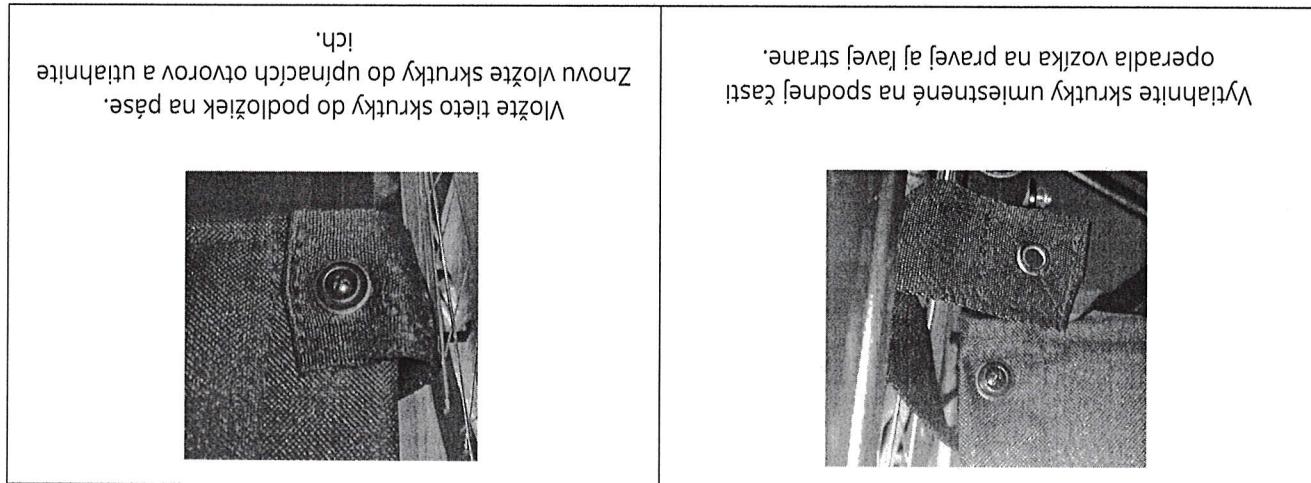

Dávajte mimoriadny pozor pôcas používania panvového pásu; pravidelne kontroľujte, či je páš správne nastavený. Nedávajte medzi pásenia a páš vložit ruku.  
Nastavenej pásu: posadte pacienta na sedadlo s chrbtom opretým o operecku. Pás je správne nastavený vtedy, keď je pás musí upveniť na rameno invalidného vozíka väčšinou predajca.

#### 4.14. Upevnenie pásu

Dávajte mimoriadny pozor pôcas používania panvového pásu; pravidelne kontroľujte, či je páš správne nastavený. Nedávajte medzi pásenia a páš vložit ruku.

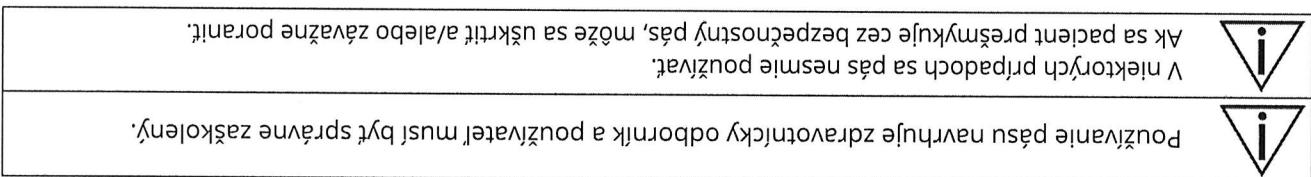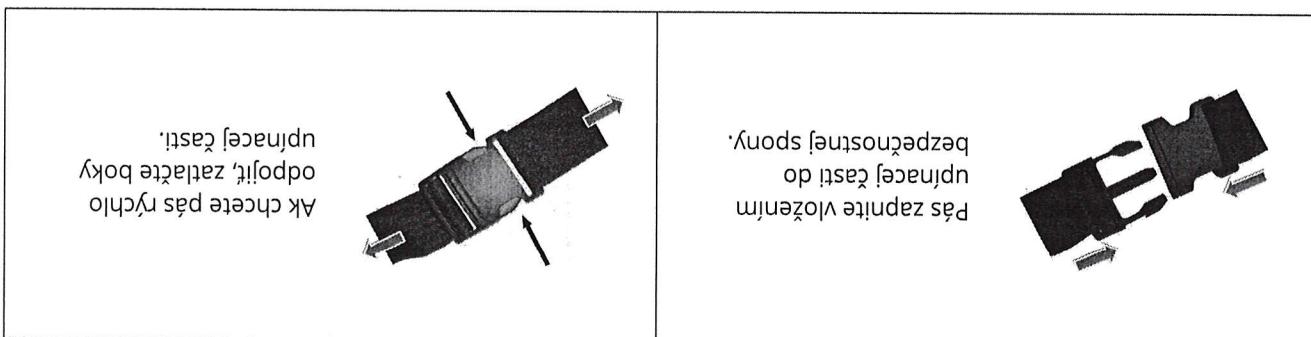

#### 4.13. Podmienky používania

invalidný vozík môže byť vybavený bezpečnostným panvovým pásem. Ten to páš bude pacientovi, aby sa zošmykoval alebo aby spadol z invalidného vozíka.

#### 4.12. Bezpečnostný panvový páš (prislúšensstvo dosťupné u väčšo predajcu)

## 5. Rýchle odstránenie poruchy



Ak zistíte chybu pri funkčnosti vozíka, ihned kontaktujte svojho predajcu.

Ked' sa bežné kontroly a údržba vykonajú správne, tento vozík vybavený pevnými/nafukovacími kolesami bude fungovať dokonalo.

V prípade zistenia chyby funkčnosti vozíka dodržujte pravidlá bezpečnosti a odstráňte bežné príčiny.

Niekteré jednoduché problémy dokáže vyriešiť používateľ, ale väčšinu opráv musí vykonať autorizovaný predajca.

Zistený problém	Jednoduchá situácia	Činnosť
Invalidný vozík nejde rovno.	Neočakávaný predmet alebo špagát zamotaný okolo osi predného kolesa.	Vyberte predmet.
Invalidný vozík nejde rovno. Odpór pri jazde sa zvyšuje (vozík sa ťažko tlačí).	Chybne alebo špinavé ložisko. Poškodená pneumatika/pevné koleso. Kolesá nie sú rovnobežné.	Pre odstránenie chyby kontaktujte predajcu.
Parkovacia brzda nefunguje.	Pneumatika/pevné koleso je opotrebované, brzda nie je nastavená.	Pre odstránenie chyby kontaktujte predajcu.
Vozík sa ťažko skladá alebo rozkladá.	Špina na piestoch.	Vyčistite vlhkou handrou a dôkladne vysušte.

## 6. Technická špecifikácia

Šírka vozika	mm	1075	1075	1075	1075	1075	cm	41	43	45	51
Celková dĺžka s opierkami na nohy	mm	1075	1075	1075	1075	1075	Dĺžka zloženého voziska s opierkami na nohy				
Celková šírka voziska v rozloženom stave	mm	622	642	662	722	722	Dĺžka bez opierok na nohy				
Výška rukoväť od zeme	mm	775	775	775	775	775	Šírka zloženého voziska				
Hmotnosť vozika	kg	18,0	18,1	18,3	18,5	18,5	Výška rukoväť od zeme				
Hmotnosť rámu bez kolies a opierok na nohy	kg	10,9	11	11,2	11,5	11,5	Hmotnosť rámu bez kolies a opierok na nohy				
Statická stabilita pri jazde dolu kopcom	stup.	20	20	20	20	20	Statická stabilita pri jazde hore kopcom				
Bocná statická stabilita	stup.	18	18	18	18	18	Bocná statická stabilita				
Šírka sedadla (vzadu)	mm	438	458	478	538	538	Šírka sedadla medzi ochrannymi krytmi obléčenia				
Výška operala	mm	425	425	425	425	425	Vzdialenosť medzi opierkou na nohy a sedadlom (*)				
Sklón operala	mm	335	335	335	335	335	Nastaviteľnosť medzi opierkou na nohy a sedadlom (*)				
Výška prednej a zadnej časti sedadla od zeme	mm	480	480	480	480	480	Vzdialenosť medzi opierkou na nohy a sedadlom				
Sklón sedadla	mm	405	425	425	425	425	Sklón medzi opierkami na nohy a sedadlom				
Hlbka sedadla	mm	425	425	425	425	425	Výška sedadla medzi opierkou na nohy a sedadlom				
Sklón operala	mm	14,5°	14,5°	14,5°	14,5°	14,5°	Sklón medzi opierkami na nohy a sedadlom				
Výška operala	mm	335	335	335	335	335	Nastaviteľnosť medzi opierkou na nohy a sedadlom (*)				
Výška prednej a zadnej časti sedadla od zeme	mm	460	460	460	460	460	Predné nastavenie konštrukcie opierok riuk.				
Sklón sedadla	mm	425	425	425	425	425	Predné nastavenie konštrukcie opierok riuk.				
Výška sedadla	mm	120°	120°	120°	120°	120°	Výška laktovej opierky od sedadla				
Sklón medzi opierkami na nohy a sedadlom	mm	260	260	260	260	260	Sklón medzi opierkami na nohy a sedadlom				
Sklón medzi opierkami na nohy a sedadlom	mm	270	270	270	270	270	Predné nastavenie konštrukcie opierok riuk.				
Poločka obracej	mm	20	20	20	20	20	Poločka panelu / Poločka vpredu				
Hrbatka otoky	mm	1256	1256	1256	1256	1256	Hrbatka otoky				
Maximálny bezpečný sklon	stup.	6°	6°	6°	6°	6°	Maximálny bezpečný sklon				
Maximálny sklon na použitie parkovaciej brzdy	stup.	7°	7°	7°	7°	7°	(*) 12 polož				
Parameetre vornkážleho prostredia							Teploota: -20 °C až +40 °C				
Vlhkosť: 20 % až 70 %											

Súčasťou sú aj testy horlavosti (EN 1021-1/2 a ISO 8191-2).

Bola použitá simuláčna figurina s hmotnosťou 120 kg.

Invalídny vozík bol testovaný v CERAH a je v súlade s normou NF EN 12182:2012 a 12183:2014.

## 6.1. Normy a nariadenia

## 7. Označenia

### 7.1. Výrobný štítok

Váš vozík má špecifické sériové číslo, ktoré sa nachádza na štítku výrobcu, pripojeného na ráme vozíka. Tento štítok obsahuje dôležité informácie, ktoré môžu byť požadované počas servisu vášho vozíka.

Poloha a popis	
	  <b>THUASNE</b> 120 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET - FRANCE <a href="http://www.thuasne.com">www.thuasne.com</a>  <b>WHEELCHAIR CLASSIC DF2</b> <b>41CM QR 24" BPU/B</b> <b>REF W5310 507 412</b> 2019-05 <b>LOT</b> 201905 <b>SN</b> XX XXXXX Made in China
Výrobca a adresa	 <b>THUASNE</b> 120 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET - FRANCE <a href="http://www.thuasne.com">www.thuasne.com</a>
Popis	<b>WHEELCHAIR CLASSIC DF2</b> <b>41CM QR 24" BPU/B</b>
Referenčné číslo	<b>REF W5310 507 412</b>
Dátum výroby	2019-05
Číslo šarže	<b>LOT</b> 201905
Sériové číslo	<b>SN</b> XX XXXXX
Pred použitím si prečítajte návod	
Maximálna hmotnosť používateľa	 < 120 Kg
Označenie CE	

### 7.2. Iné označenia

Tento vozík nie je určený na prepravu cestujúceho v motorovom vozidle.	
--	--

Tento štítok je nalepený na ráme vozíka, v blízkosti výrobného štítka.

Na cistene pôživajte tepľu vodu a neagresívne saponáty (pre domácnosť), použite handricku alebo špongiu, opravit poskodenie u svojho predajcu.

Povrchová úprava záistíme ochranu proti korózii. Ak je náter poskodený (odlupnutý náter, skrabanie), neschajte povrchovú úpravu až po skončení úpravy.

**Plastové diele**

Plastové diele utrite handricou alebo špongiou. Použite vodu a mydlo.

Tkaninu nemamáčajte, nepoužívajte paru ani agresívne roztvársťadlá.

V prípade odolných skvrn použite tepľu vodu a mydlo.

Cistite návlachenou handrickou.

**Potah sedadla a operadla**

Po použití v dázdi ho dokladne utrite handricou.

Ak je vozík špinavý, utrite ho hned ako to bude možné vložku handriou a dokladne ho osušte.

Poscas cistenia môžete zbadat uvoľnené alebo poskodené diele. Informujte o tom svojho predajcu hned ako to bude možné.

Vás invalidný vozík je mechanické vozidlo, dokladne otestovanie a navrhnutie tak, aby bolо dňohodo vykonané. Cistenej siučasťou pravidelnej údržby vozíka.

Nepoužívajte kysle a zásadité cisticace roztoky alebo kyselinu.




### 8.3. Cistenie

do väčneho zranenia a invalidný vozík by stratil garanciu záruk.

by mohli zmeniť konštrukciu invalidného vozíka a spôsobiť nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla vyuistiť Neopárvané zásahy alebo použitie náhradných dielov iných než dielov dodaných spoločnosťou Thusašne



Opravy vozíka by mali byť vykonané záskoleným servisnym technikom váslo predajcu.



Ak zistíte akúkoľvek poruchu na vozíku, obráťte sa ihned na svojho predajcu.



Odporečame vám zverit svoj vozík servisnému pracovníkovi váslo predajcu aspoň raz za rok.

V tejto časti siučasťou tabuľku odpisučaných kontrolo, ich frekvenciu a informácie o súčasťach, ktoré je potrebné prekontrolovať. V prípade pochybností o tom, ako vykonovať niektoré kontroly, sa obráťte na svojho predajcu.

Abyste nedoslo ku zraneniu, nevkladajte prsty alebo iné časti tela do pohyblivých častí.



Starajte sa o svoj invalidný vozík: pravidelne kontroly, zistovanie a odstraňenie problémov, výmena opotrebovaných dielov, zabezpečia vásmu vozíku zachovat si svoj výkon na mnoho rokov.

### 8.2. Pravidlá pre manipuláciu

Alienov klieč 6-hranec veľkosť 19 mm

Plochý klieč alebo 6-hranec klieč veľkosť 8, 10 a 13

Kružový skrutkovac Philips č. 2

### 8.1. Potrebné náradie

## 8. Návod na údržbu

### Po každom čistení

Opláchnite povrch čistou vodou.

Dabajte na to, aby sa voda a čistiace prostriedky nedostali do rúrok a aby ste povrch dôkladne opláčli.

Vysušte povrch suchou handrou.

### **Poznámka:**

Piesok alebo slaná voda môžu poškodiť funkčnosť a spôsobiť hrdzavenie oceľových prvkov. Ak je invalidný vozík vystavený morskému vzduchu, dôkladne ho vyčistite a v prípade potreby opláchnite kovové komponenty čistou vodou a vysušte ich suchou handrou.

### **8.4. Dezinfekcia**

Vozík je možné dezinfikovať rozprašovaním čistiaceho prostriedku alebo poutieraním pomocou testovaných a schválených dezinfekčných prostriedkov. Rozprašujte čistiaci prostriedok a jemný dezinfekčný prostriedok (baktericídy a fungicídy v súlade s normami EN1040 / EN1276 / EN1650) a dodržujte pokyny výrobcu.

## **8.5. Kontrola celkového stavu invalidného vozíka**

### **Skontrolujte zhodu časti**

#### **RÁM A SÚČASTI**

##### Rozloženie vozíka

Invalidný vozík sa skladá jednoducho a ľahko. Sedadlo je správne umiestnené a rovnomerne spočíva na podperách.

##### Neporušenosť rámu a súčasti

Nevykystujú sa žiadne deformácie rúrok. Nie sú viditeľné žiadne trhliny ani žiadne začínajúce pukliny. Žiadne ostré hrany alebo nerovnosti.

##### Rukoväte

Sú privarené k tlačnému ramenu operadla a sú pevne prichytené. Nie sú viditeľné žiadne trhliny ani známky roztrhnutia.

##### Antikorózna úprava

Povrchový náter je v dobrom stave. Opravte prípadné nedokonalosti, aby sa zabránilo korózii.

##### Skrutky a matice

Pomocou skrutkovača skontrolujte správne dotiahnutie skrutiek. Pomocou vhodných kľúčov skontrolujte správne dotiahnutie skrutiek a matíc. Skontrolujte, či na hlavách skrutiek a matíc nie sú hroty alebo ostré výstupky, v prípade potreby ich vymeňte.

#### **POHYBLIVÉ SÚČASTI A BRZDY**

##### Kolesá

Kolesá sa musia otáčať voľne, bez zasekávania. Skontrolujte: zakrivenie, vôľu v osi kolesa.

V prípade uvoľneného výpletu alebo oddelených špalí skontrolujte koleso alebo ihned vymenite ráfik.

##### Nafukovanie pneumatík

Skontrolujte tlak v pneumatikách, dodržujte hodnoty uvedené na bočnej strane pneumatík.

Uistite sa, že pravý a ľavý tlak sú rovnaké.

Neprekračujte maximálnu hodnotu tlaku: hrozí nebezpečenstvo prasknutia a riziko zranenia.

##### Stav pneumatík alebo pevných kolies

Pneumatiky: žiadne nadmerné opotrebovanie, žiadne trhliny.

Pevné kolesá: žiadne nadmerné opotrebovanie, trhliny, nepriľnavosť pevného kolesa k ráfiku.

##### Čapy na rýchlu demontáž

Os musí byť čistá, správna funkcia zaistovacích guličiek, axiálna vôľa je limitovaná.

##### Parkovacia brzda

Žiadna vôľa, pracuje ľahko a rovnomerne, vozík je zabrzdený okamžite.

V prípade defektu vozík nepoužívajte, pretože je nevyhľadený. Poziadajte odborníka, aby vám opravil koleso/kolesá.

## DEFEKT

Overe správne funkčiu, skontrolujte polohu a upevnenie opierky. Skontrolujte správne umiestnenie opierok ľktka.

### Drižák opierok ľktka

Pri používaní vozíka musí byť súčasťka nastavená v dolnej polohе.  
Uistite sa, že súčasťka proti prevráteniu je poradne upevnená a je správne umiestnená.

### Súčasťka proti prevráteniu

## PRÍSLUŠENSTVO (PRI NIEKTOŘICHO MODELCOH)

Overe správne funkčiu, skontrolujte správnu polohu a upevnenie plastovej opierky.

### Drižák opierok nôh

Uistite sa, že skrutky pripevňujúce opierku ruky neprenikajú do ľatlunenia.

Skontrolujte neporušenosť chránickej obliečená (bočnej výplne).

Vráťte ľch na miesto, overte funkčiu záistenia.

Skontrolujte ich funkčnosť a či sú hladké: odistrie ich a zdvihnite. Ziadna nadmera vôle, ziadne trenie na sedadlo.

### Látkové opierky

Nie sú viditeľné ziadne ostre hraný na skrutkach alebo zámkы odskrutkovania.

Skontrolujte, či sú skrutky správne zasunuté a pene dotalahute.

Ak tkanina operadla ochabuje z dôvodu intenzívneho používania, musíte pozádať o výmenu svojho predajcu.

Ziadne nátrahnutie tkaninu nie je viditeľné.

Upínacie skrutky sú riadne dotalahute.

Tkanina je napnutá.

Potač opereadla a sedadla

## SEDAĽO

V prípade akéhokoľvek poskodenia ihned vymenite obrúč.

Ziadne výstrabené povrchu obrúče, ziadne ostre hrotý ani ostre hraný nie sú viditeľné.

Bezpečne uchytene na koleso, bez vôle v upevnení.

Obrúč

Po impulze sa invalidný vozík pochybuje rovno bez trenia alebo odporu. Ziadna vôle v ložiskách kolies.

Kontrola pojazdu

Nesmie chýbať prachový kryt.

Skontrolujte pravú a ľavú symetriu. Po roztočení sa volne otáča.

Ziadna vôle, uhol paraleline s vertikálou.

Cápy validice

Ložiska musia byť čiste a musia sa lahlko sa otáčať.

Guličkové ložiske

## 8.6. Frekvencia kontrol

Invalidný vozík	každodenne	týždenne	mesačne	Komentáre
<b>Rám a súčasti</b>				
Rozloženie vozíka		x		
Neporušenosť rámu a súčastí		x		
Plastové prvky		x		
Rukoväte	x			
Antikorózna úprava			x	
Skrutky a matice		x		
Čisté piesty, bez korózie		x		
<b>Pohyblivé súčasti a brzdy</b>				
Stav pneumatík alebo pevných kolies	x			
Nafukovanie pneumatík	x			
Čapy na rýchlu demontáž		x		
Parkovacia brzda	x			
Obruče		x		
Guličkové ložiská			x	
Čapy vidlice			x	
Kontrola pojazdu			x	
Po impulze sa vozík pohybuje rovno		x		
<b>Sedadlo</b>				
Poťah operadla a sedadla		x		
Lakťové opierky		x		
<b>Držiak opierok nôh</b>				
Kontrola zaistenia		x		
Dobrý stav opierok		x		
<b>Príslušenstvo</b>				
Držiak opierok lýtku		x		
Súčiastka proti prevráteniu		x		

- Ak budete vozik dlinšiu dobu skladovat (například vícako štíří měsíace), postupujte nasledovně:
  - Děklaďané výčistite vozik, vrátané potahová koltíky a vysuště všecky jeho části;
  - Necħajte brzdy v oblokovanej polohě;
  - Charāħte ho pred prachom;
  - Udržujte ho v suchu, mimo prameho slněčného žiarenia a při izbovém teplotě.
- Pred opäťovnym používáním vozik děklaďané skontrolujte při dordžanu postupu „kontroly celkového stavu invalidného vozika“ (odsek 8.5), ktorý je popisaný v tomto návode.
- ### 8.7. Dlhodobé skladovanie invalidného vozika
- Pred opäťovným používáním vozik děklaďané skladovat (například vícakо štíří měsíace), postupujte nasledovne:
  - Děklaďané výčistite vozik, vrátané potahová koltíky a vysuště všecky jeho části;
  - Necħajte brzdy v oblokovanej polohě;
  - Charāħte ho pred prachom;
  - Udržujte ho v suchu, mimo prameho slněčného žiarenia a při izbovém teplotě.
- Pred opäťovnym používáním vozik děklaďané skontrolujte při dordžanu postupu „kontroly celkového stavu invalidného vozika“ (odsek 8.5), ktorý je popisaný v tomto návode.
- ### 8.8. Operovné použitie invalidného vozika
- Pred opäťovným používáním vozik děklaďané skontrolujte při dordžanu postupu „kontroly celkového stavu invalidného vozika“, ktorý je popisaný v odseku 8.5.
  - Uistite sa, že je vozik čistý a dezinfikovaný.
  - Děklaďané vozik skontrolujte při dordžanu postupu „kontroly celkového stavu invalidného vozika“, ktorý je popisaný v tomto návode v odseku 8.5.
  - Operujte vozik pre nového pacienta.
- ### 8.9. Predpokladaná životnosť invalidného vozika
- Za správneho používania a pri pravidelné údržbe je invalidný vozik skonstruovaný tak, aby vydržal viac ako 7 rokov.
- Osťatné diele, ktoré podliehajú běžnému opotrebovaniu pri používaní vozika (potah sedadla alebo operadla, laktové opierky ruky, pene ve koliesa, pneumaticky...), sa budú musieť nahradit v rámci běžnéj údržby.
- Na invalidného voziku sa vozíruje záruká na výrobne vady 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka je obmedzená na bezplatné výmenu posudnených chybnych dieleov dôdavateľom. Záruka sa nevzťahuje na výmenu běžného opotrebováních náhradných dieleov z dôvodu používania vozika (potah sedadla alebo operadla, laktové opierky, opierky ruky, pene ve koliesa, pneumaticky...).

## **9. Záručný list**

THUASNE SK, s.r.o – zákaznícky servis

Mokráň záhon 4

821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 4910 4088, -89, +421 903 720138

Sme presvedčení, že tento výrobok vás plne uspokojuje. V prípade, že potrebujete kontaktovať náš záručný alebo pozáručný servis, obráťte sa na predajcu, ktorý vám ho predal.

Na invalidné vozíky Thuasne sa vzťahuje záruka na výrobné vady dva roky od dátumu zakúpenia. Záruka je obmedzená na bezplatnú výmenu posúdených chybných dielov dodávateľom.

### **Podmienky účinnosti záruky**

Záruka sa nevzťahuje na výmenu bežne opotrebovaných náhradných dielov z dôvodu používania vozíka (poťah sedadla alebo operadla, laktové opierky, opierky rúk, pevné kolesá, pneumatiky...).


Záruka na invalidný vozík sa vzťahuje iba vtedy, ak boli dodržané pokyny pre údržbu a používanie.

### **Invalidný vozík typu Classic DF 2 - W5310**

Sériové číslo: .....

Dátum zakúpenia: .....

Pečiatka predajcu:

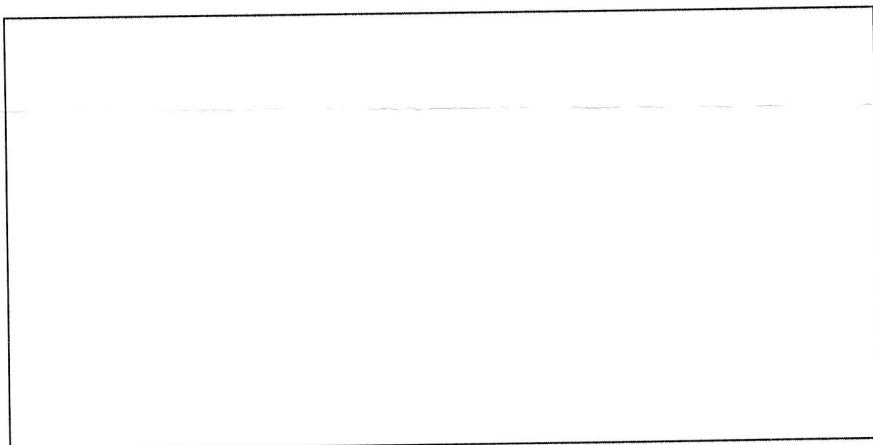

Tento produkt je v súlade so smernicou 93/42/CEE vzťahujúcou sa na zdravotnícke pomôcky.



[www.thusaSNE.com](http://www.thusaSNE.com)

83 Fumin Lin Lu, Mayfair Tower, 4th Floor, Office 812, Jing'an District - Shanghai, 200040, P.R. CHINA

**ThusaSNE (Shanghai) Medical Devices Co., Ltd.**

4615 Shepard Street - Bakerfield, CA 93313 - USA

**Townsend Design**

United Kingdom

Unit 4 Orchard Business Centre - North Farm Road - Tunbridge Wells - Kent TN2 3XF -

**ThusaSNE UK Ltd**

6 Hanagar St., POB 2447, Kfar Saba 4442536 - Israel

**ThusaSNE Cervitex Ltd**

Łazy, Al. Krakowska 202, 05-552 Magdalanka - Poland

**ThusaSNE Polska Sp. z.o.o.**

Ryssviksvägen 2, 131 36 Nacka - Sweden

**ThusaSNE Scandinavia AB**

Mokrany zahor 4 - 821 04 Bratislava - Slovensko

**ThusaSNE SK, s.r.o.**

111 Budapest, Budafoki ut 60 - Magyarország

**ThusaSNE Hungary Kft.**

Naskove 3 - 150 00 Praha 5 - Česká republika

**ThusaSNE CR s.r.o.**

C/Avenida 22 Nave 4, Poligono industrial Polvoranca, CP 28914 Leganés, Madrid - España

**ThusaSNE España SLU**

Via L. Capuana, 27 - 20825 Barlassina (MB) - Italia

**ThusaSNE Italia srl.**

Klompenmaker 1-3, 3861 SK Nijkerk - Nederland

**ThusaSNE Benelux B.V.**

Im Stelenkamp 12 - 30938 Burghwedel - Deutschland

**ThusaSNE Deutschland GmbH**

Distribución

Tel. +33 (0)4 77 81 40 01/02 (Export)

Objednávky (St-Etienne): Tel. 04 77 81 40 42 (Francúzska)

92300 Levallois-Perret - France

120 rue Mauritius Aufran

**THUSA SNE**



**CE**